

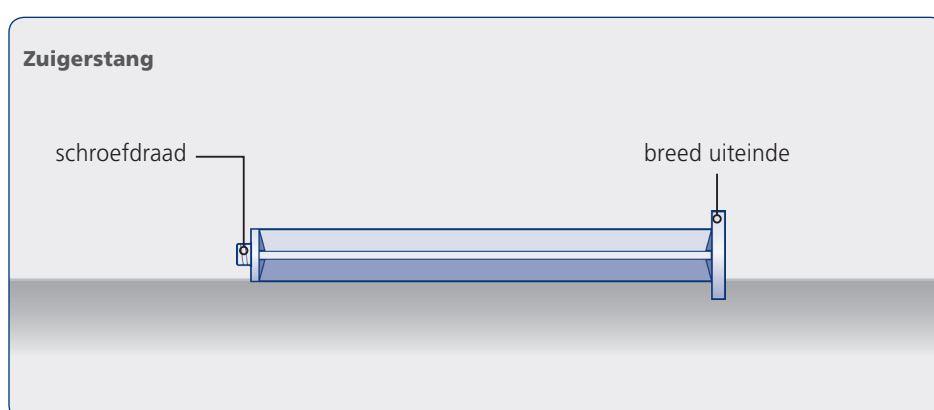
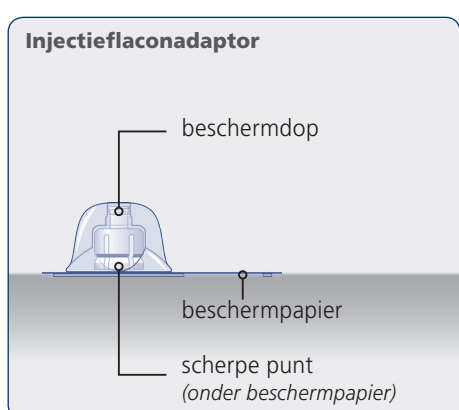


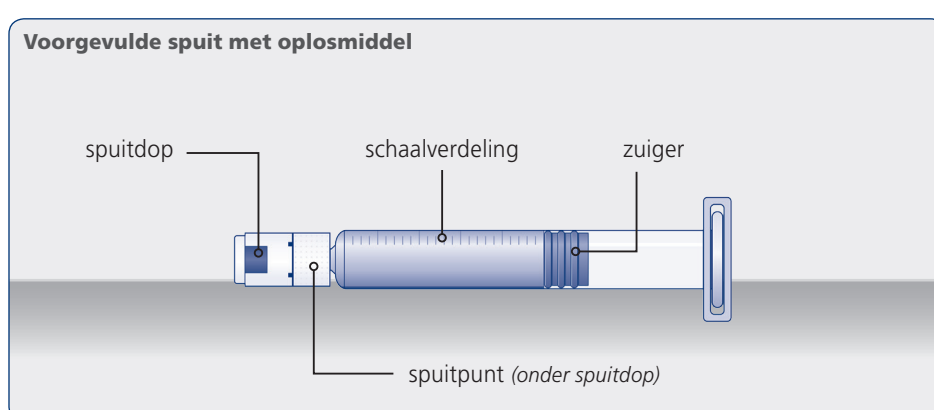


Richtlijnen voor het gebruik van NovoSeven®

Overzicht

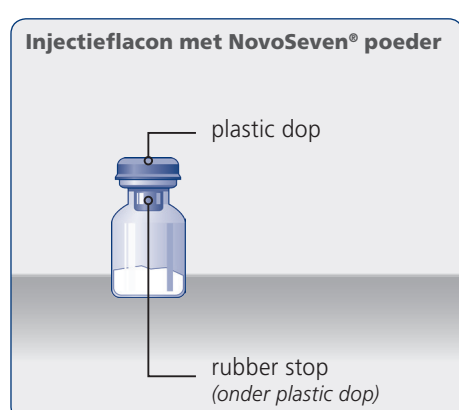


1 Klaarmaken van de injectieflacon en de spuit

- Pak het aantal NovoSeven® verpakkingen dat nodig is.
- Controleer de houdbaarheidsdatum.
- Controleer de naam, sterkte en kleur van de verpakking en verzeker u ervan dat het het juiste geneesmiddel bevat.
- Was uw handen en laat ze goed drogen aan de lucht of gebruik een schone handdoek.
- Haal de injectieflacon, de injectieflaconadapter en de voorgevulde spuit uit de doos. **Laat de zuigerstang onaangeroerd in de doos.**
- Laat de injectieflacon en de voorgevulde spuit op kamertemperatuur komen (niet boven 37°C). U kunt dit doen door deze in uw handen te houden tot ze zo warm aanvoelen als uw handen.
- Gebruik geen enkele andere manier om de injectieflacon en de voorgevulde spuit op te warmen.

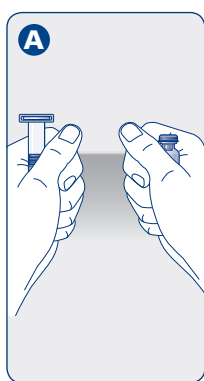

- Verwijder de plastic dop van de injectieflacon. Als de plastic dop los zit of ontbreekt, gebruik de injectieflacon dan niet.

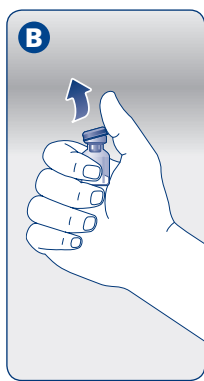


- Reinig de rubber stop met een steriel alcoholdoekje en laat deze voor gebruik enkele seconden aan de lucht drogen om er zeker van te zijn dat deze zo ziektekienvrij als mogelijk is.


- Raak de rubber stop niet met uw vingers aan omdat dit ziektekiemen kan overbrengen.

2 Bevestig de injectieflaconadapter


- Verwijder het beschermpapier van de injectieflaconadapter. Gebruik de injectieflaconadapter niet als het beschermpapier niet helemaal dichtgeplakt is of als het gescheurd is.
- Haal de injectieflaconadapter niet met uw vingers uit de beschermcap. Als u de scherpe punt van de injectieflaconadapter aanraakt, kunnen ziektekiemen van uw vingers worden overgebracht.

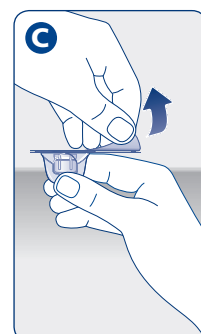

- Plaats de injectieflacon op een platte en stevige ondergrond.
- Draai de beschermcap om en druk de injectieflaconadapter op de injectieflacon.
- Haal de injectieflaconadapter niet meer van de injectieflacon als deze bevestigd is.




- Knijp zachtjes in de beschermcap met uw duim en wijsvinger zoals op de tekening weergegeven is. Verwijder de beschermcap van de injectieflaconadapter.
- Haal de injectieflaconadapter niet van de injectieflacon terwijl u de beschermcap verwijdert.

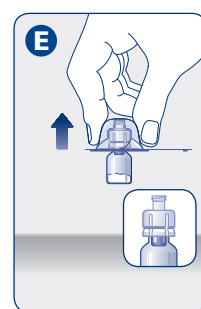


3 Bevestig de zuigerstang en de spuit


- Pak de zuigerstang vast bij het brede uiteinde van de bovenkant en haal deze uit de kartonnen doos. Raak de uiteinden of het schroefdraad van de zuigerstang niet aan. Als u de uiteinden of het schroefdraad aanraakt, kunnen ziektekiemen van uw vingers worden overgebracht. Bevestig de zuigerstang onmiddellijk aan de spuit door hem met de klok mee in de zuiger van de voorgevulde spuit te draaien totdat u weerstand voelt.



- Verwijder de dop van de voorgevulde spuit door deze te buigen totdat deze afbreekt bij de perforatierand.
- Raak de punt van de spuit onder de spuitdop niet aan. Als u de punt van de spuit aanraakt, kunnen ziektekiemen van uw vingers worden overgebracht.
- Als de dop van de spuit loszit of ontbreekt, gebruik de voorgevulde spuit dan niet.




- Schroef de voorgevulde spuit stevig op de injectieflaconadapter totdat u weerstand voelt.




4 Meng het poeder met het oplosmiddel


- Houd de voorgevulde spuit een beetje schuin met de injectieflacon naar beneden gericht.
- Druk de zuigerstang in om alle oplosmiddel in de injectieflacon te spuiten.




- Houd de zuigerstang ingedrukt en draai de injectieflacon rustig rond tot alle poeder is opgelost. Schud de injectieflacon niet omdat dit schuimen veroorzaakt.
- Controleer de gemengde oplossing. Deze moet kleurloos zijn. Als u zichtbare deeltjes of verkleuring ziet mag u het niet gebruiken. Gebruik dan een nieuwe verpakking.

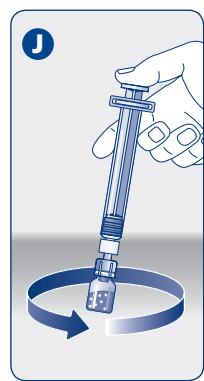

- Houd de zuigerstang volledig ingedrukt.
- Keer de spuit met de injectieflacon erop ondersteboven.
- Druk niet meer op de zuigerstang en laat deze langzaam teruggliden terwijl de spuit zich vult met de gemengde oplossing.
- Trek de zuigerstang een beetje naar beneden om de gemengde oplossing in de spuit te zuigen.
- In het geval dat u maar een deel van de gemengde oplossing nodig heeft, gebruik dan de schaalverdeling op de spuit om te zien hoeveel van de gemengde oplossing u uit de injectieflacon neemt, zoals verteld door uw arts of verpleegkundige.
- Als er op enig moment teveel lucht in de spuit zit, spuit de lucht dan terug in de injectieflacon.
- Tik zachtjes op de spuit, terwijl u de injectieflacon ondersteboven houdt, zodat eventuele luchtbellen naar boven gaan.
- Duw de zuigerstang langzaam in totdat alle luchtbellen verdwenen zijn.

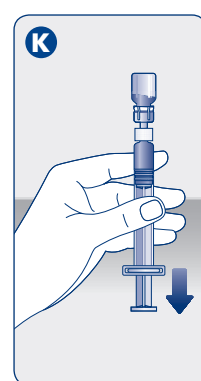

- Schroef de injectieflaconadapter met daarop de injectieflacon los.
- Raak de punt van de spuit niet aan. Als u de punt van de spuit aanraakt, kunnen ziektekiemen van uw vingers worden overgebracht.



Gebruik de gemengde NovoSeven® onmiddellijk om infecties te voorkomen. Als u het niet onmiddellijk kunt gebruiken, zie rubriek 5 Hoe bewaart u NovoSeven® aan de ommezijde van deze bijsluiter. Bewaar de gemengde oplossing niet zonder advies van uw arts of verpleegkundige. Als u een hogere dosis nodig heeft dan 1 injectieflacon bevat, herhaal dan stappen A tot en met J met extra injectieflacons, injectieflaconadapters en voorgevulde spuiten totdat u de benodigde dosis heeft bereikt.

Het injecteren van NovoSeven® met voorgevulde spuit middels naadloze verbindingstukken voor intraveneuze (IV) katheters

Waarschuwing: De voorgevulde injectiespuit is gemaakt van glas en is ontworpen om compatibel te zijn met standaard luer-lock aansluitingen. Sommige naadloze verbindingstukken met een inwendige scherpe punt zijn incompatibel met de voorgevulde injectiespuit. Deze incompatibiliteit kan toediening van het geneesmiddel verhinderen/of resulteren in beschadiging van het naadloze verbindingstuk.

Volg de gebruiksinstructies voor het naadloze verbindingstuk. Toediening via een naadloos verbindingstuk kan optrekking van de bereide oplossing in een plastic, steriele, standaard 10 ml luer-lock injectiespuit vereisen. Dit dient direct na stap J gedaan te worden.

5 Inspuiten van de gemengde oplossing

NovoSeven® is nu klaar om in uw bloedvat te worden ingespoten.

- Spuit de gemengde oplossing in zoals verteld door uw arts of verpleegkundige.
- Spuit langzaam in gedurende 2 tot 5 minuten.

De oplossing injecteren middels een centraal veneus toegangshulpmiddel (CVAD) zoals een centraal veneuze katheter of een subcutane poort:

- Hanteer een schone en ziektekienvrije (aseptische) werkwijze. Volg de instructies voor correct gebruik van uw verbindingstuk en CVAD in overleg met uw arts of verpleegkundige.
- Voor het injecteren in een CVAD kan het gebruik van een 10 ml plastic spuit nodig zijn om de gemengde vloeistof op te trekken.
- Als de CVAD-slang gespoeld moet worden voor of na de NovoSeven® injectie, gebruik dan een natriumchloride 9 mg/ml oplossing voor injectie.

Weggoien

- Gooi, na het inspuiten, de spuit met de infusieset, de injectieflacon met de injectieflaconadapter, ongebruikt NovoSeven® en andere afvalmaterialen op een veilige manier weg zoals verteld door uw arts of verpleegkundige.

- Gooi het niet weg met het huishoudelijk afval.

Haal het materiaal niet uit elkaar voordat u het weggooit.

Gebruik het materiaal niet opnieuw.

Novo Nordisk B.V.

Flemingweg 18
2408 AV Alphen aan den Rijn
T +31 (0)172 44 96 00
informatie@novonordisk.com

www.novonordisk.nl
changing possibilities in haemophilia

changing possibilities
in haemophilia

